

Kurzanleitung – Lyme/ Borreliose Schnelltest

1. Entweder:

<p>A. Serum oder Plasma</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 µl Serum oder Plasma • 3 Tropfen Puffer (ca. 120 µl) 	<p>B. Venöses Vollblut</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 µl Vollblut aus der Vene • 3 Tropfen Puffer (ca. 120 µl) 	<p>C. Kapillares Vollblut aus der Fingerkuppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 µl Vollblut aus der Fingerkuppe • 3 Tropfen Puffer (ca. 120 µl)
--	--	--


2. 10 Minuten warten



- **Nicht länger als 20 Minuten** mit dem Ergebnis-ablesen warten!

3. Testergebnis ablesen

Borreliose IgM positiv:

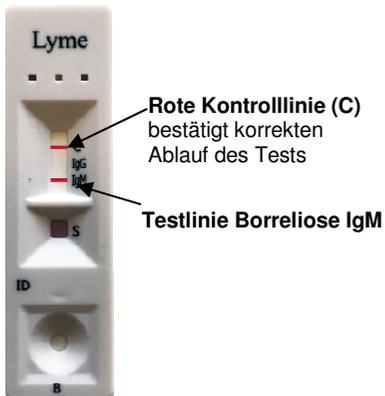

Eine rote Testlinie (IgM) und eine rote Kontrolllinie erscheinen im Sichtfenster

Borreliose IgG positiv:



Eine rote Testlinie (IgG) und eine rote Kontrolllinie erscheinen im Sichtfenster

Borreliose IgM + IgG positiv:



Zwei rote Testlinien (IgM und IgG) und eine rote Kontrolllinie erscheinen im Sichtfenster

Borreliose negativ:



Nur eine rote Kontrolllinie erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 10 bis 20 Minuten ablesen!

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Kontrolllinie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!