



Centre Suisse de Contrôle de Qualité
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Centro Svizzero di Controllo della Qualità
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg Poste CH SA

Willi Fox GmbH Medizinalprodukte
Frau Sandra Kohlbrenner
Pfluggässlein 14
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2021-11-02

Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 21-10-TO


Sehr geehrte Damen und Herren

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.

Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
1500	U-Amphetamine, gesamt		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	Konform
1501	U-Barbiturate		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
1502	U-Benzodiazepine		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	Konform
1504	U-Cannabinoid		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
1505	U-Kokain		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	Konform
1509	U-MDMA		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
1510	U-Methadon		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
1511	U-Methamphetamin		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
1513	U-Opiate		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform


U-Amphetamine, gesamt [1500]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	99	153
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Barbiturate [1501]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	71	107
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Benzodiazepine [1502]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	96	150
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Cannabinoid [1504]

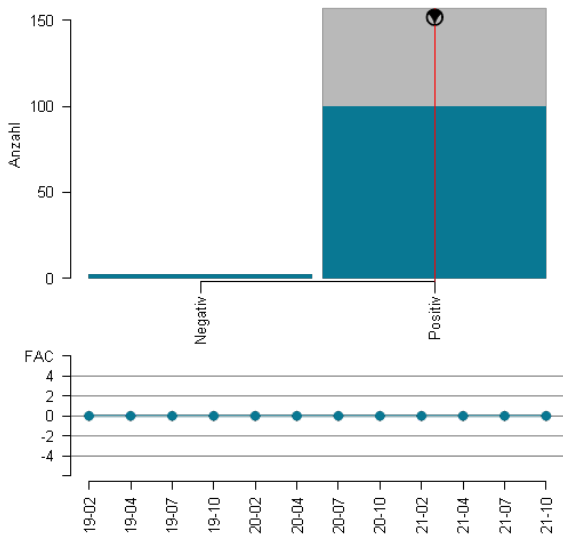

Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	102	159
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Kokain [1505]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	104	161
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-MDMA [1509]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	47	52
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	--
SD :	--	--
VK :	--	--


U-Methadon [1510]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	74	116
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	--
SD :	--	--
VK :	--	--


U-Methamphetamin [1511]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	82	87
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	--
SD :	--	--
VK :	--	--

U-Opiate [1513]



Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Positiv

QUALAB Auswertung : Konform

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet)

Z-Score : --

Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	102	158
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

Kommentare zu den Resultaten

- Insgesamt sind bei diesem Ringversuch die Resultate sehr gut.
- Drogenmissbrauch: Die Probe war positiv für Barbiturate (Secobarbital 2085 µg/L), Buprenorphin (26 µg/L), Cannabinoid (THC-COOH 218 µg/L), LSD (0,83 µg/L), Methadon (780 µg/L), Opiate (Morphin 4141 µg/L), Paracetamol (240 µmol/L) und Ethanol (34 mmol/L).

Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

24. Januar 2022, 28. März 2022, 04. Juli 2022, 03. Oktober 2022

Genehmigung

Bericht genehmigt von:

D. Kessler (Direktorin), Dr. L. Vernez (Ringversuchsbeauftragte), M.-L. Cartier (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung inbegriffen.



Services suisses d'essais d'aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

SPTS 0004

Kontakt

CSCQ
2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.: +41 (0) 22 305 52 31
Fax: +41 (0) 22 305 52 38
E-mail: cscq@hcuge.ch
Web: www.cscq.ch

Vorgehensweise bei Nicht-Erfüllen der Beurteilungskriterien:

« Das Labor ist verpflichtet, den Ursachen ungenügender Resultate auf den Grund zu gehen und die entsprechende Dokumentation aufzubewahren (mind. 5 Jahre), in Papierform und/oder elektronisch. Sind die Beurteilungskriterien und die Erfüllungskriterien für einen Parameter nicht erfüllt, muss das Labor zur Besprechung der Probleme mit dem Qualitätskontrollzentrum Kontakt aufnehmen um den Ursprung des Problems zu suchen. »

QUALAB, Externe obligatorische Qualitätskontrolle, 2021, Kapitel 4.3.2.

Ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ dürfen Auszüge dieses Berichtes nicht kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.