



Centre Suisse de Contrôle de Qualité  
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle  
Centro Svizzero di Controllo della Qualità  
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air  
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg    Poste CH SA

Willi Fox GmbH Medizinalprodukte  
Frau Sandra Kohlbrenner  
Freie Strasse 45  
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2023-07-17

## Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 23-06-MA


Sehr geehrte Damen und Herren

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.

## Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

| Code | Analyt                       | Einheit | Zielwert | Ihr Resultat | FAC Auswertung | QUALAB Auswertung |
|------|------------------------------|---------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 371  | S-Troponin I ql              |         | Negativ  | Negativ      | Ausgezeichnet  | keine Vorgabe     |
| 372  | S-CK - MB Masse ql           |         | Negativ  | Negativ      | Ausgezeichnet  | keine Vorgabe     |
| 373  | S-Myoglobin ql (Schnelltest) |         | Negativ  | Negativ      | Ausgezeichnet  | keine Vorgabe     |

### S-Troponin I ql [371]

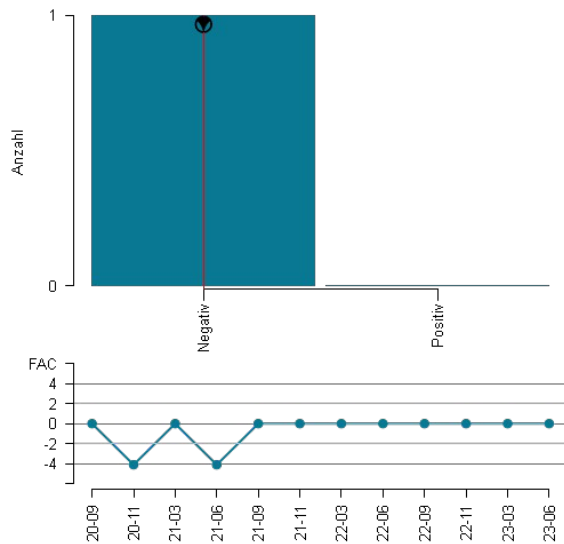

#### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

▼ Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : keine Vorgabe

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet) ●

Z-Score : --

#### Methode Trop-I QI [897]

Anzahl Teilnehmer : 1


○ Zielwert : Negativ

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

### S-CK - MB Masse ql [372]



#### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

▼ Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : keine Vorgabe

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet) ●

Z-Score : --

#### Methode CKMB QI [898]

Anzahl Teilnehmer : 1


○ Zielwert : Negativ

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

## S-Myoglobin ql (Schnelltest) [373]



### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : keine Vorgabe

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet)

Z-Score : --

### Methode Myogl. QI [899]

Anzahl Teilnehmer : 1

Zielwert : Negativ

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

## Kommentare zu den Resultaten

Insgesamt sind die Resultate sehr gut.

## Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

21. August 2023, 30. Oktober 2023, 26. Februar 2024, 27. Mai 2024

## Genehmigung

Bericht genehmigt von:

D. Kessler (Direktorin), M.-A. Perles (Ringversuchsbeauftragte), S. Mancino (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung inbegriffen.



SPTS 0004

Services suisses d'essais d'aptitude  
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen  
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio  
Swiss proficiency testing services

## Kontakt

CSCQ  
2 chemin du Petit-Bel-Air  
CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.: +41 (0) 22 305 52 31  
Fax: +41 (0) 22 305 52 38  
E-mail: cscq@hcuge.ch  
Web: www.cscq.ch

Jedes Labor muss möglichen Ursachen ungenügender Resultate nachgehen (s. CSCQ-Teilnehmerhandbuch).

Stabilität und Homogenität intern hergestellter Prüfgegenstände werden durch das CSCQ überprüft. Bei von ausserhalb erworbenen aufbereiteten Proben werden diese Eigenschaften durch den Unterauftragnehmer kontrolliert und durch das CSCQ attestiert.

Ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ dürfen Auszüge dieses Berichtes nicht kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.